



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΥΗΙ

Ιωάννινα 28-04-2026
Αριθ. Πρωτ.9531

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099855

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
ΥΗΙ

Πληροφορίες : Π.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
E-mail : pmichaloroulou@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια πάγκου εργασίας για τις ανάγκες των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.

ΣΧΕΤ.:
α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
η Ν.5218/2025
θ Ν.4865/2025
ι. Η αρ.21/29-01-2026 αίτηση προμήθειας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
κ.Η αρ.3254/08-04-2026 εντολή προμήθειας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 08-05-2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με πεινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
6. Η διάρκεια ισχύος.
7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

- Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : €558,03

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
 Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3254
 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 08/04/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 08/04/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ			ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	4430 ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 526	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 21	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.				
Παρατ.Αίτ.Προμ.				
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			
	ΑΔΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10005236	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	TEM	1,00	450,0000	
2010005236000009	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	24,00	31204010000001	558,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 558,03

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ PROSPECTUS

ΕΙΔΟΣ: 1) ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΆΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1) ΕΠΙΠΛΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Πρόκειται για ντουλάπι - ερμάριο. Οι διαστάσεις αποτυπώνονται στο σχέδιο.

A) Κάτω μέρος

Επιφάνεια εργασίας (τεμ. 1): Η οριζόντια επιφάνεια εργασίας θα είναι τύπου πάγκου κουζίνας 3 cm, λεία, με κούρμπια.

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm και φέρει εσωτερικά διάτρηση σε όλο το ύψος, ώστε να είναι δυνατή η εκ' των υστέρων προσθήκη ραφιών .

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 25 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Πόδια: Στη βάση προσαρμόζονται τέσσερα πλαστικά κυλινδρικά πόδια διαστάσεων 3 cm ύψος και 5 cm διάμετρος και σε ένα εξ' αυτών πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της βάσης από τη στάθμη δαπέδου.


Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm.

Ερμάριο (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Το ερμάριο θα φέρει 2 ανοιγόμενες θύρες και 1 ενδιάμεσο ράφι και επιπλέον, τα πλαϊνά του θα είναι διάτρητα εκατέρωθεν, ώστε το ράφι να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο κατά το δοκούν.

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90ο. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 2 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σόκορα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό (<50%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σόκορου.

Συρτάρι - Βαγονέτο (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 16 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm ενώ η πρόσοψή του θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Οι μηχανισμοί ανοίγματος θα είναι τηλεσκοπικοί βαρέως τύπου. Στο βαγονέτο θα τοποθετηθούν 2 ενδιάμεσα χωρίσματα όπως φαίνεται στο σχέδιο από plexiglass πάχους 5 mm, σε ειδικές εγκοπές 6-7 mm στα περιμετρικά τοιχώματα του συρταριού - βαγονέτου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 4 διακριτοί χώροι για το διαχωρισμό και την οργάνωση του φαρμακευτικού υλικού.

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΓΟΝΕΤΟΥ

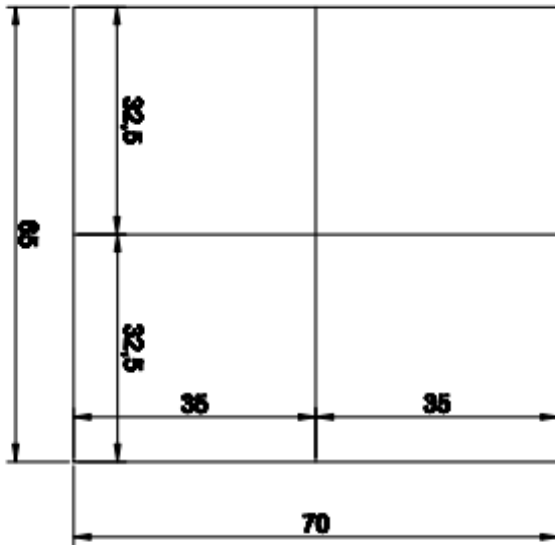

Πόμολα (τεμ. 3): Όλα τα πόμολα θα είναι μακρόστενα μήκους περίπου 10 cm, θα είναι μασίφ, νίκελ και λεία, χωρίς εγκοπές. Στο συρτάρι θα τοποθετηθεί οριζόντια και στις πόρτες των ντουλαπιών κατακόρυφα.

Κλειδαριές (τεμ. 2): Θα τοποθετηθεί κλειδαριά στο συρτάρι και στο δίφυλλο ερμάριο θα τοποθετηθεί κλειδαριά και σύρτης πάνω και κάτω εσωτερικά στο ερμάριο, ώστε να ασφαλίζουν και τα δύο φύλλα. Ο σύρτης θα είναι βαρέως τύπου στρόγγυλος με γόνα. Υποχρεωτικά να προσκομισθεί δείγμα του σύρτη και της κλειδαριάς. Θα παραδοθεί σετ των 3 κλειδιών.

β) Πάνω μέρος

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Δεν θα είναι συνεχόμενη με την πλάτη του κάτω μέρος, για να δύναται να αποσπαστεί από αυτήν.

Πλαϊνά ψηλά (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Δεν θα είναι συνεχόμενα με τα πλαϊνά του κάτω μέρος, για να δύναται να αποσπαστούν από αυτά.

Πλαϊνά χαμηλά (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Δεν θα είναι συνεχόμενα με τα πλαϊνά του κάτω μέρος, για να δύναται να αποσπαστούν από αυτά.

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 18 mm., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm.


Ράφι (τεμ. 2 ράφια): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. Τα ράφια στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα.

γ) Περιθώριο - Χρωματισμός - Συνδεσμολογία

Περιθώριο: Στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι σκούρο γκρι – ανθρακί για να κάνει αντίθεση με την υπόλοιπη ντουλάπα. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και του ειδικού τεμαχίου.

Χρωματισμός: Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας (επιφάνειες μελαμίνης ανοιχτό γκρι και όλα τα εμφανή σόκορα σκούρο γκρι – ανθρακί).

Συνδεσμολογία: Οι συνδέσεις στα εμφανή σημεία θα γίνουν με καβίλιες.

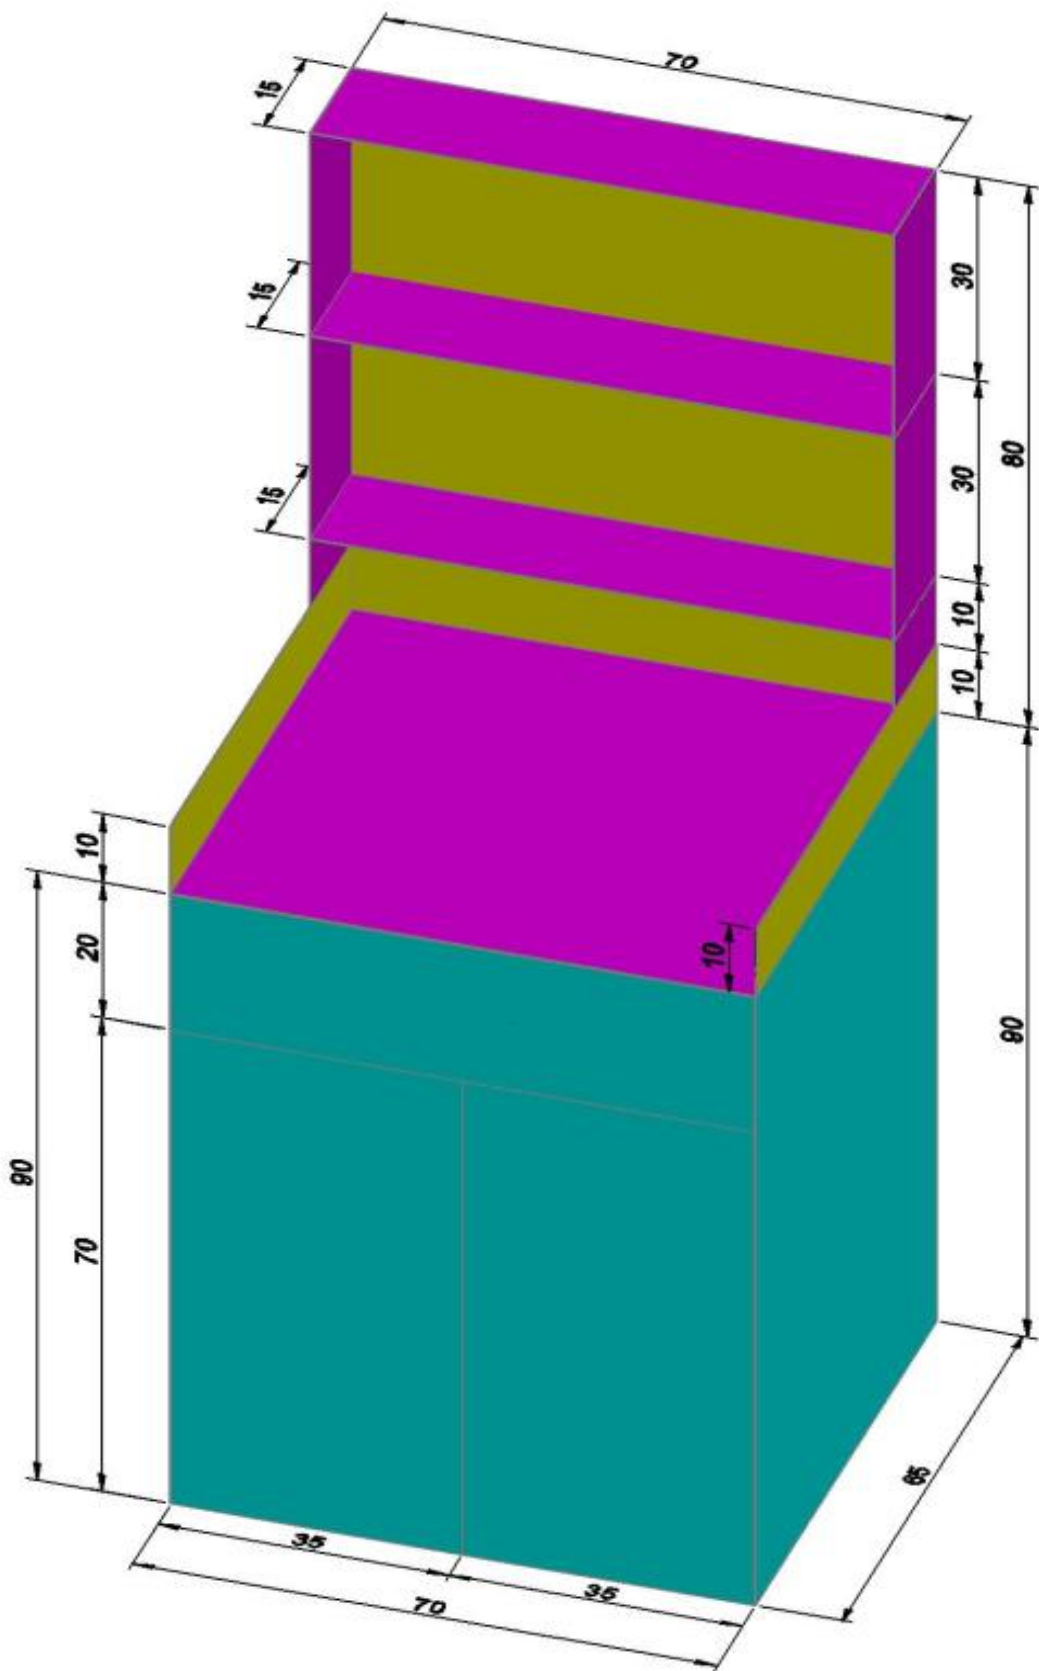


2) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πρόκειται για επιφάνεια που θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο πάγκο εργασίας. Οι διαστάσεις αποτυπώνονται στο σχέδιο.

Επιφάνεια εργασίας (τεμ. 1): Η οριζόντια επιφάνεια εργασίας θα είναι τύπου πάγκου κουζίνας 3 cm, λεία, με κούρμπα.

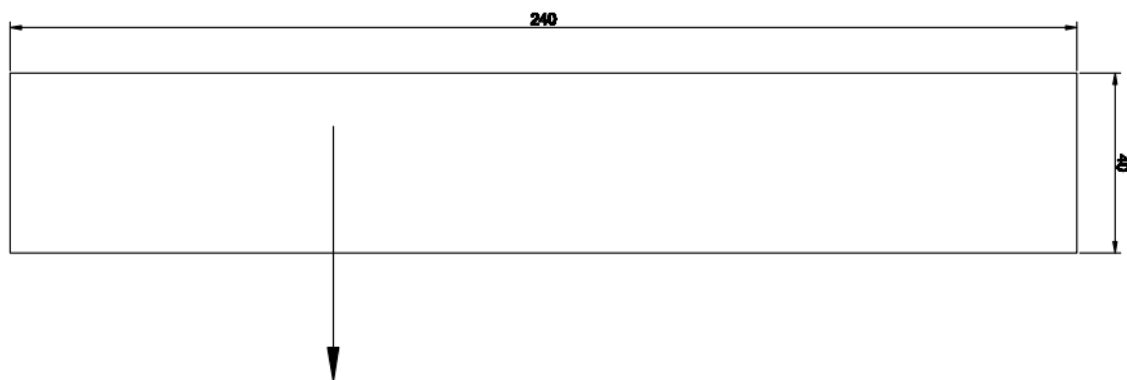ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΚΙΣΕ**ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ